





福岡医発第1849号(地)

平成15年 1月17日



各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師
会 長 関 原 敬 次



平成14年度(第31回)精度管理調査結果研修会
の開催について(ご案内)

厳寒の候 貴職益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

本会では、県下の公・私立病院、診療所、保健所、登録衛生検査所の臨床検査室による日々の成績がどれくらいの信頼度か、また過去の値と比較してどうであるかなど、県下の臨床検査精度をなべて高めることを目的として、昭和47年より臨床検査精度管理調査を毎年実施しておりますが、この度、本年度の調査結果発表を兼ねた研修会を別紙日程のとおり開催いたします。

つきましては、貴職より平成14年度(第31回)精度管理調査への参加の有無にかかわらず、本会精度管理調査のあり方と、調査結果を中心とした各施設それぞれの問題点の解明とその解決法、更には県下の検査値統一化を目指しております本会の姿勢等につきましてもご理解を賜りたく、各施設長並びに臨床検査技師各位が多数この研修会にご参加下さいますようご高配願います。

なお、

- 1) 別紙のとおり各関係機関には本会より直接ご案内申し上げます。
- 2) 昨年度より福岡県医師会臨床検査精度管理調査を、県内施設一括して九州臨床検査精度管理調査に参加して行うことになり、研修会当日の午前中は別紙日程のとおり九州臨床検査精度管理調査報告会が開催されますので、併せてご出席いただきますようご案内申し上げます。
- 3) 調査参加施設の調査結果は、午後から開催いたします本会の調査結果研修会の受付でお渡しいたします。
- 4) 別添用紙により出欠の有無を折り返しFAXでご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- 5) 本会では、平成8年より検査値の施設間格差をなくし、更に有効利用されることを目的とした「検査値標準化」のプロジェクトを立ち上げ積極的に推進いたしております。

福岡県医師会精度管理調査の目標値の「値付け」は五病院会(九州大学病院・福岡大学病院・福岡大学筑紫病院・久留米大学病院・産業医科大学病院・飯塚病院)で行っていますが、その基礎になるのは、認証標準物質(CRM)または常用酵素標準物質(ERM)を用いて確認したものです。

従って全国に通用する検査値になっていきますので、別紙「福岡県医師会共通基準範囲」をご使用いただけないようございまして、今後は是非、「福岡県医師会共通基準範囲」をご使用いただきますよう貴職よりご高配いただきますようお願い申し上げます。

平成14年度(第31回)精度管理調査結果研修会日程

△と き 平成15年2月23日(日) 14:00~16:00

△ところ 都久志会館

福岡市中央区天神4丁目8-10

092-741-3335

1. 開 会

2. 挨拶

3. 教育講演 I (14:05~14:25)

「輸血業務の査察と認証 (Inspection and Accreditation)」

講 師: 久留米大学医学部臨床検査部教授

佐 川 公 矯

4. 精度管理調査報告 (14:25~15:40)

- | | | |
|---------------------|------------------|--------------|
| 1) HCV抗体、HBs抗原 | 久留米大学病院臨床検査部 | 豊 田 尚 子(10分) |
| 2) PSA、CA19-9 | 久留米大学病院臨床検査部 | 浮 池 俊 憲(10分) |
| 3) 血液型、不規則抗体 | 福岡大学病院臨床検査部 | 川 島 博 信(10分) |
| 4) ALP、LD | 産業医科大学病院臨床検査部 | 池 田 勝 義(10分) |
| 5) 鉄・クレアチニン | 九州厚生年金病院中央検査室 | 名 川 和 代(10分) |
| 6) CHO、HDL、中性脂肪 | 浜の町病院臨床検査部 | 大 石 潔(10分) |
| 7) PT、APTT、フィブリノーゲン | 九州大学医学部附属病院中央検査室 | 栗 原 正 子(15分) |

5. 教育講演 II (15:40~16:00)

「自己抗体検査の精度管理の試み」

講 師: 産業医科大学病院中央臨床検査部教授

大 田 俊 行

6. 閉 会

第31回（平成14年度実施分） 九州臨床検査精度管理研究会 御案内

謹啓 貴施設に於かれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、臨床検査の精度の向上を目的として発足致しましたこの研究会も、今年度で第31回を迎えるまでになりました。これもひとえにこの研究会の主旨をご理解頂き、参加して頂きました各施設の皆様のご協力があったことと、心から感謝いたしております。

昨年9月に実施致しました精度管理調査では、免疫血清、生化学、尿、血液凝固、微生物、輸血（不規則抗体）を実施致しました。それらの結果集計が出来ましたのでお送りいたします。

これらの資料を基に更に解析を加え、その結果の発表と参加された皆様との討論会を下記日程で開催致しますので、万障お繰り合わせの上ご参加頂きますようご案内申し上げます。

なお今年度の特別講演は、九州大学の濱崎直孝教授に「精度管理の標準化について」のテーマで講演していただきます。

敬具

平成15年1月15日

九州臨床検査精度管理研究会
会長 岡部 紘明

記

日時 平成15年2月23日（日曜日）
午前 9時～12時30分

場所 都久志会館
福岡市博多区中央区天神4-8-10
電話 092（741）3335

免疫血清及び生化学部門発表会

於 都久志会館ホール 9：00～11：45

微生物部門発表会

於 4階会議室 9：00～11：45

特別講演

於 都久志会館ホール 11：50～12：30

九州臨床衛生検査技師会生涯教育研修会

※ホールと会議室が離れていますのでご注意ください。

※会場の都久志会館は駐車場がありませんので近辺の駐車場をご利用ください。

第31回九州臨床検査精度管理研究会プログラム

◎免疫血清・生化学部門 (於 都久志会館ホール)

開会挨拶

熊本大学 岡部 紘明

1 免疫血清部門

司会

長崎大学
国立佐賀病院

上平 憲
河野 義彦

- 1) E I A
 - 2) 免疫グロブリン, 補体価, C R P
 - 3) 梅毒, H B s, H C V
 - 4) 輸血 (不規則抗体)
- 質疑応答

福岡大学筑紫病院
諫早総合病院
鹿児島大学
大村市立病院

篠原 克幸
今里 和義
宝蔵 正信
福田 肇

2 生化学部門

司会

長崎大学
福岡大学

一瀬 博
井本 祐司

- 1) 尿
- 2) 血液凝固
- 3) H b A 1 c
- 4) H D L, C H O L, T G, L D L
- 5) B U N
- 6) 蛋白分画
- 7) D - B I L, U A
- 8) C K
- 9) A L P, γ - G T P
- 10) C a
- 11) F e
- 12) N a, K, C l
- 13) L D

福岡大学
九州大学
福岡大学
大分医科大学
佐賀県立好生館
宮崎医科大学
熊本中央病院
長崎大学
琉球大学
飯塚病院
九州大学
長門記念病院
産業医科大学

園田 美百子
飯田 廣子
井本 祐司
和氣 智徳
出 美規子
木田 信章
竹下 久子
一瀬 博
金城 徹
中島 久美子
豊福 美津子
濱野 貴磨
池田 勝義

今年度の総括

産業医科大学

池田 勝義

質疑応答

指定演題

司会

久留米大学

矢野 順子

「本年度解析結果の見方」

日水製薬 (株)

高橋 義孝

特別講演

司会

熊本大学

岡部 紘明

「精度管理の標準化について」

講師

九州大学

濱崎 直孝

◎ 微生物部門 (於 都久志会館 4階会議室)

1 配布試料のデーター解析

司会	長崎大学 国立嬉野病院	松田 淳一 横溝 勝
1) 試料 N O 25		
試料 N O 26	国立都城病院	斉藤 宏
試料 N O 27	公立玉名中央病院	永田 邦昭
2) 薬剤感受性		

長崎大学 松田 淳一

質疑応答

2 講演

司会	琉球大学	山根 誠久
演題 「ラオスにおける感染症事情」		
講師 琉球大学		仲宗根 勇
演題 「国際感染症サーベイランスの活動と概況」		
講師 国際保健医療交流センター		蟻田 功

福岡県医師会共通基準範囲

臨床化学検査値 23 項目

項 目	範 囲	単 位	項 目	範 囲	単 位
TP	6.7～ 8.3	g/dl	TG	M38～207	mg/dl
ALB	4.0～ 5.0	g/dl	TG	F 30～137	mg/dl
BUN	8 ～ 22	mg/dl	グルコース ^{*1}	69～104	mg/dl
クレアチニン	M0.6～ 1.1	mg/dl	グルコース ^{*2}	80～112	mg/dl
クレアチニン	F0.4～ 0.7	mg/dl	AST	13～ 33	U/l
UA	M3.6～ 8.0	mg/dl	ALT	M 8～ 42	U/l
UA	F2.3～ 5.5	mg/dl	ALT	F 6～ 27	U/l
TB	0.3～ 1.5	mg/dl	ALP	115～359	U/l
Na	138 ～146	mmol/l	LD (L)	119～229	U/l
K	3.6～ 4.9	mmol/l	LD (P)	261～483	U/l
Cl	99 ～109	mmol/l	CK	M62～287	U/l
Ca	8.7～ 10.3	mg/dl	CK	F 45～163	U/l
IP	2.5～ 4.7	mg/dl	アミラーゼ	50～159	U/l
TC	128 ～256	mg/dl	ChE	107～233	U/l
HDL-C	41 ～ 96	mg/dl	GGT (γ GT)	10～ 47	U/l

*1ブレーン管 *2解糖阻止剤入採血管

病態識別値を付記する項目

項 目	範 囲	単 位	根 拠
TC	128～220	mg/dl	日本動脈硬化学会コンセンサスカンファランスより
TG	30～150	mg/dl	
TB	0.3～1.2	mg/dl	体質性黄疸の鑑別上
UA M	3.6～7.0	mg/dl	日本プリン・ピリミジン代謝学会コンセンサスカンファランスより
F	2.3～7.0	mg/dl	
ALT	6～30	U/l	病理学的所見上

(福岡県五病院会設定)

(高齢者用基準範囲 参考文献)

豊福 美津子 他・外来患者データを用いた高齢者年齢別基準範囲の推定

臨床病理、第47巻第2号、P165～169、1999

FAX送付先：福岡県医師会、地域医療課 宛

FAX番号：092-411-6858

平成14年度（第31回）精度管理調査結果研修会について

I. 九州臨床検査精度管理調査報告会

△とき 平成15年2月23日（日）10:00～12:30

△ところ 都久志会館

① 御出席

出席者氏名	医療機関名	[福岡県医師会共通基準範囲]使用の有無 ※○で囲んで下さい。	使用していない理由をお書き願います。
		使用している 使用していない	
		使用している 使用していない	
		使用している 使用していない	
		使用している 使用していない	

② 御欠席

II. 平成14年度（第31回）精度管理調査結果研修会

△とき 平成15年2月23日（日）14:00～16:00

△ところ 都久志会館

① 御出席

出席者氏名	医療機関名	[福岡県医師会共通基準範囲]使用の有無 ※○で囲んで下さい。	使用していない理由をお書き願います。
		使用している 使用していない	
		使用している 使用していない	
		使用している 使用していない	
		使用している 使用していない	


② 御欠席

※出席者多数の場合はコピーして御使用下さい

郡市医師会名

医師会

都久志会館 交通のご案内

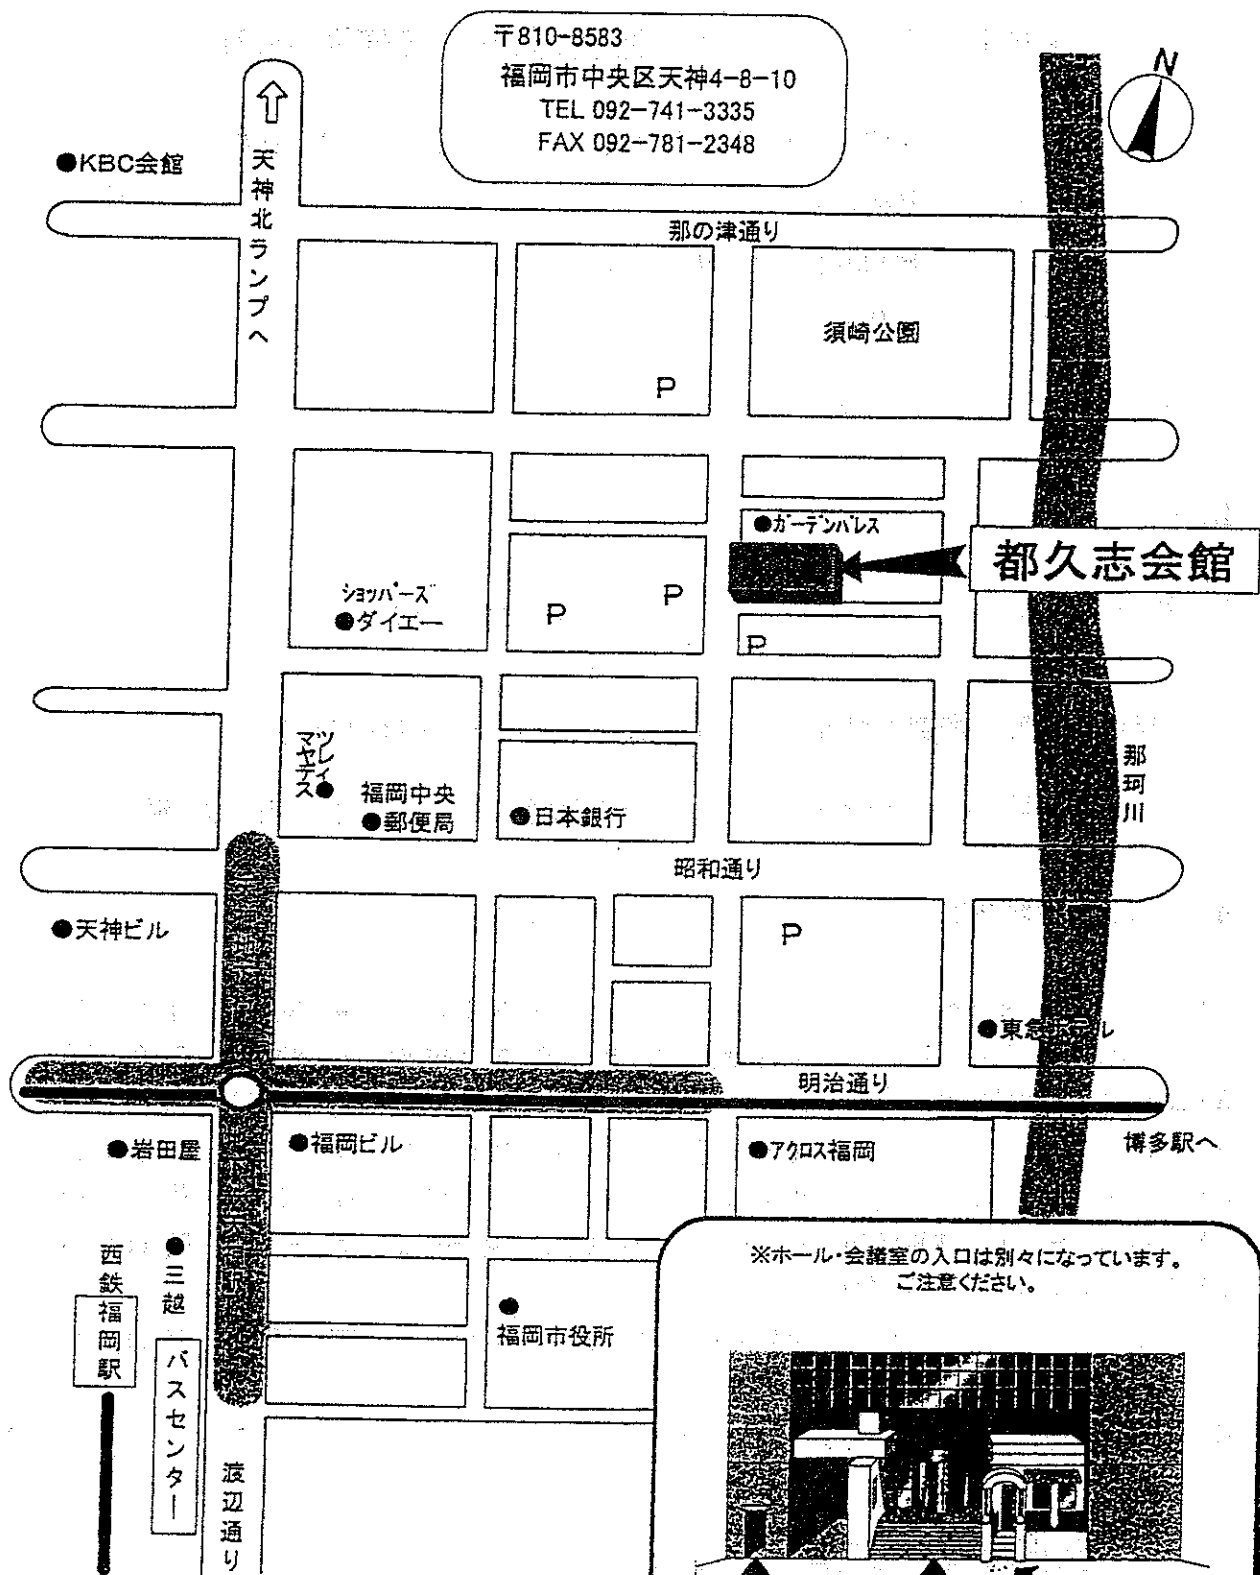

※駐車場はありません。

お近くの有料駐車場をご利用ください。
地図のPの表示が有料駐車場です

- 地下鉄天神駅より…徒歩8分
- 西鉄福岡駅・天神バスセンターより…徒歩10分
- JR博多駅より…地下鉄乗車6分、天神駅下車徒歩8分
- 福岡空港より…地下鉄乗車11分、天神駅下車徒歩8分