

福岡県医第1763号(地)

平成20年11月20日

各 医 師 会 長 殿



福岡県医師会

会長 横倉 義武

(公 印 省 略)

安全使用共通認識ポスターの改定について

標記の件につきまして、日本医師会より別紙のとおり周知方依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

本件は、輸液製剤協議会において、医療安全推進週間（平成20年11月23日～29日）に向けて、安全使用共通認識ポスター『バッグ型キット製剤の隔壁開通忘れ防止啓発ポスター』が別紙（写）のとおり改定されたものです。

今回の改定版では、各医療機関で採用されている製剤写真を掲載することにより、オリジナルポスターを各医療機関で独自に作成できるようにポスター下部にスペースが設けられております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただきますとともに、各医療機関における医療安全推進にご活用いただけるよう、貴会会員への周知方につきご高配賜りますようお願い申し上げます。

なお、本ポスターの電子データ（PDF 形式）は、輸液製剤協議会ウェブサイト（URL：<http://www.yueki.com/>）のWhat's new からダウンロードすることができます。（製剤写真は各社ウェブサイトからダウンロードできます。）

小郡三井医師会より

医療安全管理担当理事 島田昇二郎
会長 丸山 泉




(医安 66)F

平成 20 年 11 月 19 日

都道府県医師会
医療安全担当理事殿

日本医師会常任理事
木下 勝之



安全使用共通認識ポスターの改定について

今般、輸液製剤協議会長より別添の通り、本会宛連絡がありました。つきましては、下記の点について、貴会管下会員へのご周知方よろしくお願い致します。

記

輸液製剤協議会にて「バッグ型キット製剤の隔壁開通忘れ防止啓発ポスター」の改定を行った。

今回の改訂により、ポスター下部のスペースに、各医療機関で採用されている製剤写真を掲載することが可能になり、オリジナルのポスターを独自に作成できるようになった。

なお、ポスターの電子データ(6_mWdzECUYwWBXwete.pdf)は、輸液製剤協議会 Web サイト(<http://www.yueki.com/index.php>)の What's new からダウンロードできる。

キット製剤は、点滴バッグ内に隔壁が設けられており、投与前に隔壁を開通、薬剤を溶解させた後、患者に静注するものである。開通しないで使用すると危険であるため、使用前には開通を必ず確認されたい。

医療安全推進週間(11月23日～11月29日)を機会に、この改定された安全使用共通認識ポスターを活用し、医療安全推進に役立てていただきたい。


以上

輸液協発第19号

2008年11月18日

社団法人 日本医師会

会長 唐澤 祥人 殿

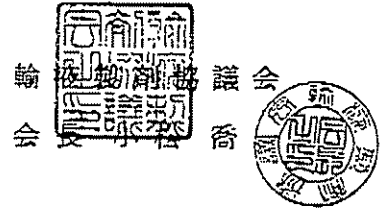

安全使用共通認識ポスターの改定について

拝啓 向寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、当協議会では、医療安全推進週間（平成20年11月23日～29日）に向けて、安全使用共通認識ポスター『バッグ型キット製剤の隔壁開通忘れ防止啓発ポスター』を改定いたしましたので、ご案内申し上げます。

本ポスターは、厚生労働省医薬食品局通知「医薬品医療事故防止対策の強化・徹底について」（平成16年6月2日付薬食発第0602009号）に基づき、平成16年に当協議会で初版を作成し、各医療機関に対して会員各社MRを通じて配布を行ったものです。（平成17年にも改定版を配布）


このたびの改定版では、各医療機関で採用されている製剤写真を掲載することにより、オリジナルポスターを各医療機関で独自に作成いただけますよう、ポスター下部にスペースのみ設けております。本ポスターの電子データ（PDF形式）は、輸液製剤協議会ウェブサイト（URL: <http://www.yueki.com/>）のWhat's new からダウンロードしていただくことも可能です。（なお、製剤写真は各社ウェブサイトからダウンロードできます。）貴会会員の各医療機関における医療安全推進にご活用いただけると幸いです。

当協議会では、輸液製剤に関する医療過誤防止に向けた取組みを行っておりますので、今後とも、ご指導・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。末筆ですが、貴会の益々のご発展をお祈り申し上げます。

敬具

バッグ型キット製剤のご使用前には、 **隔壁開通**を必ずご確認ください。

● 開通しないでご使用になると**危険**です ●

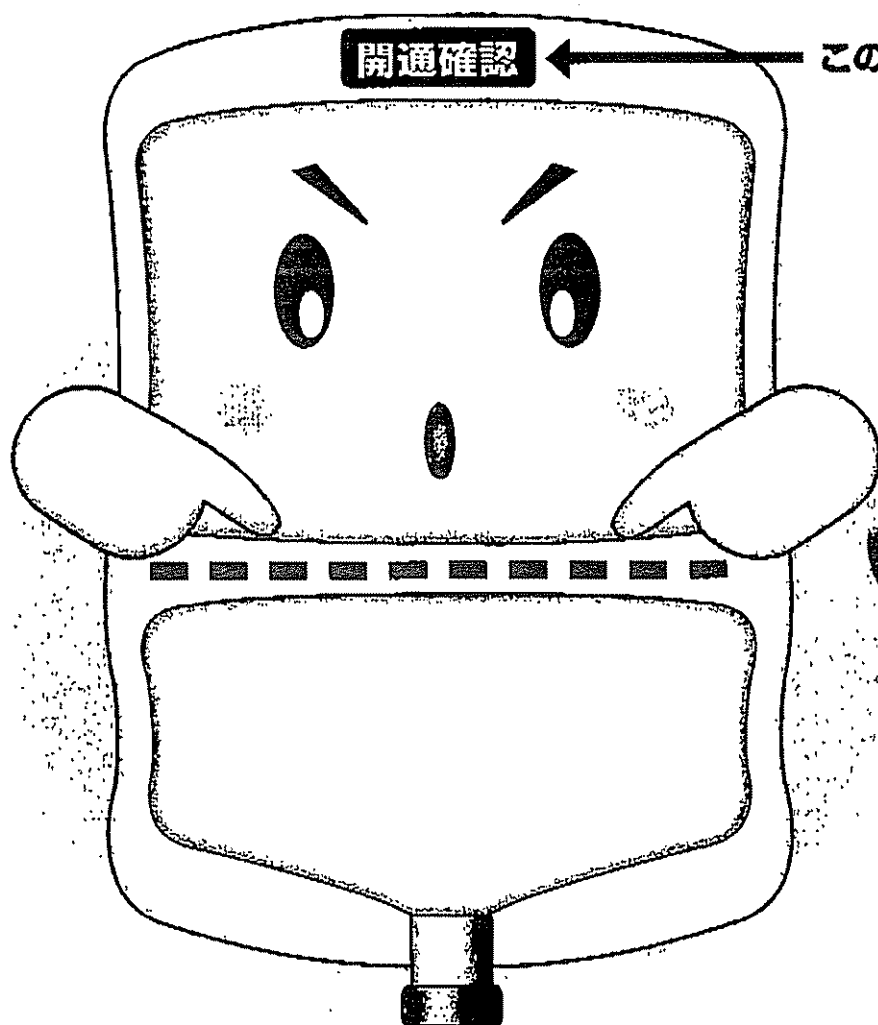

このシールでもう一度確認してね。

**ここを
開通させてね**

**隔壁未開通の事例が
報告されています。**

バッグ型キット製剤にはさまざまな形状があります。各々の製剤の使用方法を確認しご使用ください。

〈輸液製剤協議会〉

ホームページ: <http://www.yueki.com>