



福岡県医第2082号(地)

平成22年 2月18日

各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会

会長 横倉 義武

(公印省略)

医療事故防止に関する資料のご案内について

春寒の候、貴職ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、輸液製剤協議会では、昨年11月の医療安全推進週間に、医療事故防止のための取組みの一環として、輸液製剤の医療事故に関する資料を作成し啓発活動が行われております。今般、本協議会ウェブサイト、改めて各資料に関する情報が掲載された旨、日本医師会を通じ別添のとおり案内が参りました。

つきましては、貴会におかれましても下記の点にご了知頂くとともに、貴会会員への周知方につきご高配賜りますようお願い申し上げます。

なお、本資料は、日本医師会ホームページ内「患者の安全確保対策室／安全対策マニュアルダウンロード&リンク」の「輸液」欄からもダウンロードできます。<http://www.med.or.jp/anzen/manual.html>

記

輸液製剤協議会は、医療事故防止に関して、3つの資料を作成し、ウェブサイトに掲載した。http://yueki.com/anti_malpractice.php

- 1) 「バッグ型キット製剤の隔壁開通忘れ防止啓発ポスター」
- 2) 「3つの安心ポスター」
- 3) 「コアリングに要注意！」

また、滅菌関係や保管条件など、輸液に関するよくある質問・回答もウェブサイトに掲載している。<http://yueki.com/faq.php>

各医療機関においては、上記ポスター等を医療安全推進にご活用頂くとともに、輸液製剤協議会がウェブサイトで発する情報にもご留意頂きたい。

小郡三井医師会より

医療安全管理担当理事 島田昇二郎
会長 丸山 泉




(法安 74)F

平成 22 年 2 月 16 日

都道府県医師会
医療安全担当理事殿

日本医師会常任理事

木下 勝



医療事故防止に関する資材のご案内について

今般、輸液製剤協議会長より別添の通り、本会宛連絡がありました。つきましては、下記の点について、貴会管下会員へのご周知方よろしくお願い致します。

なお、日医ホームページ内の患者の安全確保対策室／安全対策マニュアルダウンロード&リンク (<http://www.med.or.jp/anzen/manual.html>) の「輸液」欄からも資料をダウンロードできますのでご活用下さい。

記

輸液製剤協議会は、医療事故防止に関して、3 つの資材を作成し、ウェブサイト (http://yueki.com/anti_malpractice.php) に掲載した。

- 1) 『バッグ型キット製剤の隔壁開通忘れ防止啓発ポスター』
- 2) 『3つの安心ポスター』
- 3) 『コアリングに要注意！』

また、滅菌関係や保管条件など、輸液に関するよくある質問・回答も、ウェブサイト (<http://yueki.com/faq.php>) に掲載している。


各医療機関においては、上記ポスター等を医療安全推進にご活用いただくとともに、輸液製剤協議会がウェブサイトで発する情報にもご留意いただきたい。

以上



輸液協発第 14 号
2010 年 2 月 15 日

社団法人 日本医師会 御中

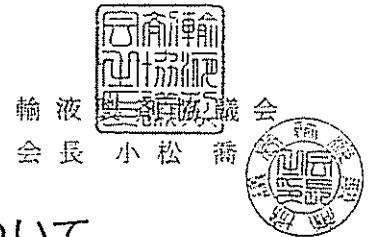

医療事故防止に関する資材のご案内について

拝啓 向春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当協議会では、昨年 11 月の医療安全推進週間（平成 21 年 11 月 22 日～28 日）に、医療事故防止のための取り組みの一環として、輸液製剤の医療事故防止に関する資材を作成して啓発活動を行って参りました。

この度、当協議会のウェブサイトにも改めて各資材に関する情報を掲載致しましたので、貴会会員にご活用いただきたく、ご案内申し上げます。

<輸液製剤の医療事故防止に関する資材>

- ① 安全使用共通認識ポスター（バッグ型キット製剤の隔壁開通忘れ防止啓発ポスター）
- ② 3つの安心ポスター
- ③ 広告「コアリングに要注意！」（『エキスパートナース』2009 年 11 月号に広告掲載）

①のポスターは、厚生労働省 医薬食品局通知「医薬品医療事故防止対策の強化・徹底について」（平成 16 年 6 月 2 日付薬食発第 0602009 号）に基づき作成し、再版を重ねて参ったものです。また、②のポスターは、今般、医薬品の表示に関する 3 つの変更（バーコード表示、施用部位表示、販売名変更）をお知らせするために作成したものです。なお、①②については、昨年 10 月より当協議会に加盟各社の MR より、医療機関への直接配布を行っております。

③の広告については、『エキスパートナース』（照林社、2009 年 11 月）に掲載された、コアリング防止のための取り組みです。①②のポスターと併せて、各医療機関における医療安全の推進にご活用いただけますと幸いです。


上記 3 資材に関連する情報は、輸液製剤協議会ウェブサイト（URL：<http://www.yueki.com/>）の「医療過誤防止に向けての取り組み」（URL：http://www.yueki.com/anti_malpractice.php）に掲載されておりますので、併せてご参照いただけますと幸いです。

なお、当協議会では今回ご案内している資材以外にも、ウェブサイトの「よくある質問・用語解説」（URL：<http://www.yueki.com/faq.php>）で輸液製剤に関して「よくある質問」等を掲載するなど、ウェブサイトを通じた医療事故防止等に関する情報発信に取り組んでおります。これからも当協議会ではウェブサイトの充実など、医療事故防止に関する情報発信に取り組んで参りますので、今後ともご指導・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。末筆ですが、貴会の益々のご発展をお祈り申し上げます。

敬具

バッグ型キット製剤のご使用前には、 隔壁開通を必ずご確認ください。

● 開通しないでご使用になると危険です ●

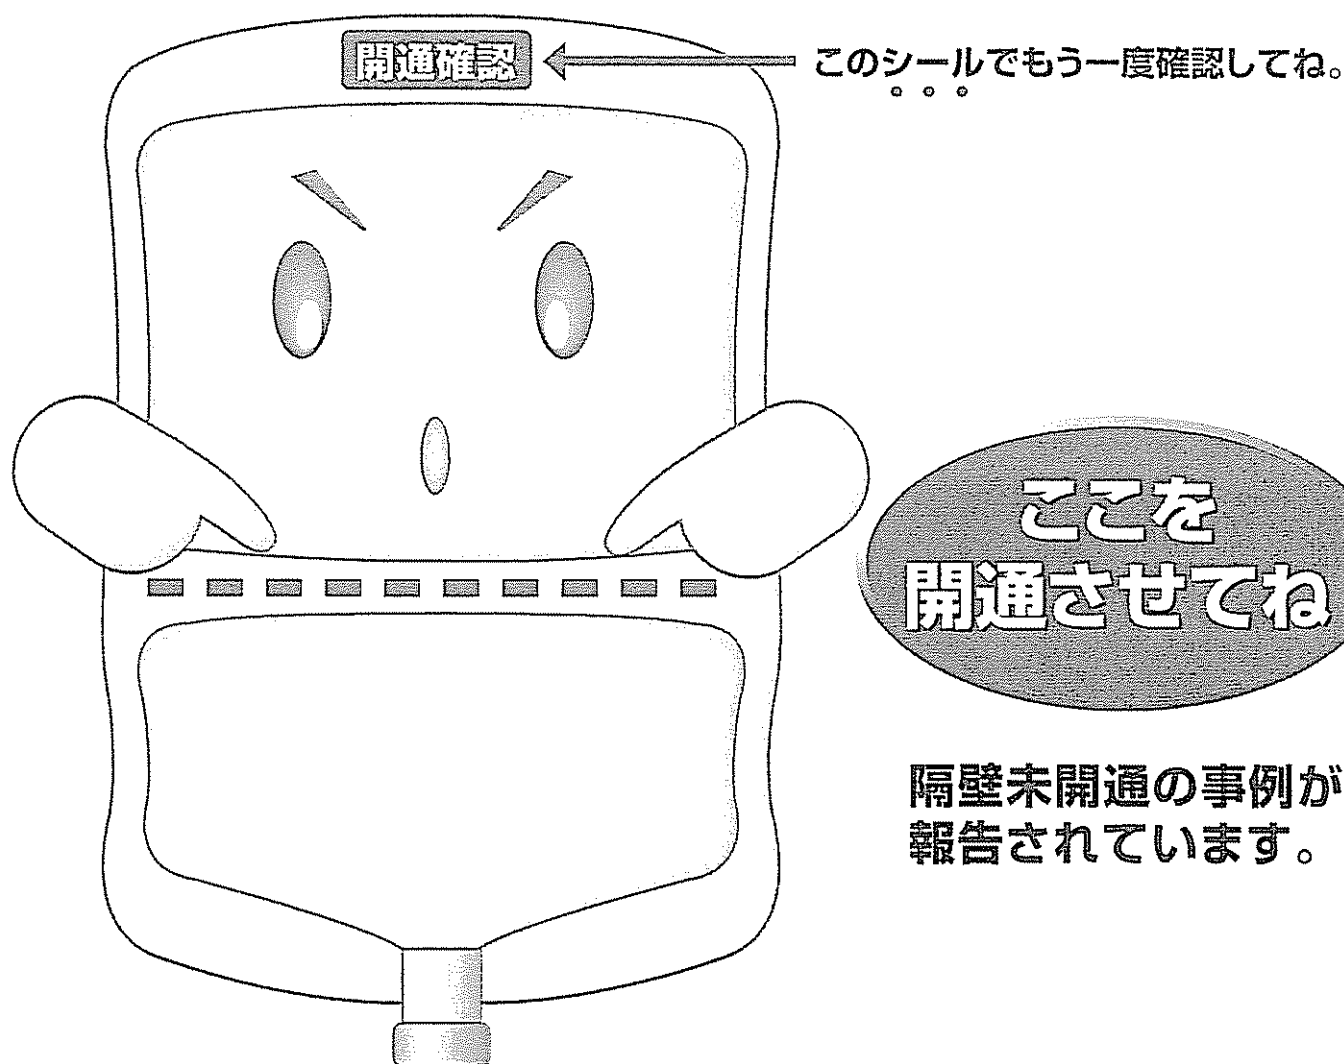

バッグ型キット製剤にはさまざまな形状があります。
各々の製剤の使用方法を確認しご使用ください。

〈輸液製剤協議会〉

ホームページ： <http://www.yueki.com>

より安心して輸液製剤をご使用いただくために

全ての輸液製剤に

「3つの安心」がプラスされます！

①施用部位の表示を
「点滴専用」と
分かりやすくしました。

点滴専用

平成19年9月19日付
日薬連発第529号

②販売名に
「輸液」等の剤型表記
を追加しました。

○○○○輸液

平成20年2月1日付
日薬連発第57号
平成12年9月19日付
医薬発第935号

③新バーコードを
表示しました。
(RSSバーコード)

平成18年9月15日付
薬食安発第0915001号

＜輸液製剤協議会＞


アイロム製薬㈱・味の素㈱・大塚製薬㈱・㈱大塚製薬工場・川澄化学工業㈱・興和㈱・テルモ㈱・ニプロファーマ㈱
日本製薬㈱・光製薬㈱・扶桑薬品工業㈱・フレゼニウスカービジャパン㈱・マイラン製薬㈱

「コアリング」に要注意!

輸液容器に注射針を刺す時、
是非とも覚えておかなければならないことがあります。
それは「コアリング」の防止です。

注射針の先端は、横から見ると斜めになっています。ゴム栓に対して斜めに針を刺すと、針のヒール部でゴム栓が削り取られてしまうことがあります。また、刺しながら針を回転させたりすることでも同様のことが起こります。何度も穿刺する場合は、同じ場所に針を刺すと前回刺した穴の側面を削り取ってしまい、「コアリング」の危険性が高まります。さらに、ゴム栓の材質や形状、注射針の径や形状にも影響されます。



正しく輸液容器に穿刺するには、指定された場所（ない場合は中央付近）に、針を垂直に押し込むことが大切です。患者さんに注射をする際、針を寝かせて斜めに穿刺することの多い看護師さんにとって、針を垂直に刺すことに抵抗を感じる人もいるかもしれません。でも、「コアリング」を防止するためには大切なことなのです。

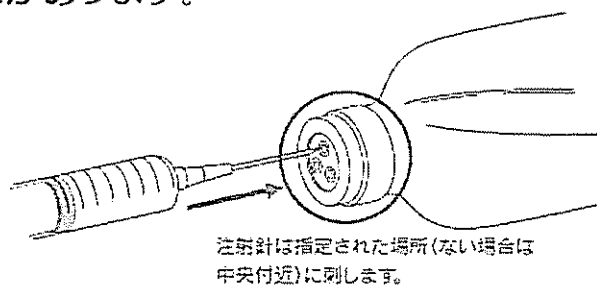


注射針は指定された場所（ない場合は中央付近）に刺します。

「コアリング」とは
注射針をゴム栓に穿刺するとき、
注射針のヒール部により
ゴム片が削り取られ、
容器内に混入してしまうことだよ。


輸液製剤協議会
キャラクター
のぞきちゃん




正しい刺し方
(垂直にゆっくり)

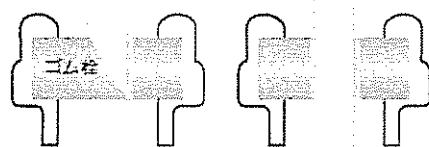

間違った刺し方
(コアリングが発生します)

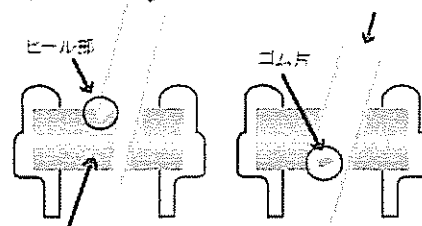

斜めに注射針を刺すと、針のヒール部(頸部)によってゴム栓が削り取られる。



輸液製剤協議会
The Intravenous Solutions Society

<http://www.yueki.com/>

