



福島医発第 3404 号（地）
令和 4 年 3 月 7 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 蓮 澤 浩 明
(公 印 省 略)

武田/モデルナ社ワクチンの外箱及び元寸法変更について

今般、標記について、厚生労働省より日本医師会を通じて、別紙のとおり連絡がありました。

本件は、武田/モデルナ社ワクチンの販売名が「スパイクバックスTM筋注（旧販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注）」に変更されることに伴い、別添「『COVID-19ワクチンモデルナ筋注』の販売名、外箱寸法等の変更について」のとおり、それらの箱の寸法が変更になる旨、お知らせするものです。

また、武田薬品工業社からの情報によれば、TM3rd03クール及びTMdp3rd01クール（2月21日週配送）の配送分からほとんどのワクチンが「スパイクバックスTM筋注」に切り替わる見込みです。

外箱及び元箱の寸法の変更に伴う冷凍庫への収納可能箱数の変更があり、特に、日本フリーザー社の冷凍庫については、元箱のまま冷凍庫内に収納することができなくなったため、ワクチン配送時に担当者にて速やかに開梱し、外箱で当該冷凍庫に収納する必要があります（詳細は別添をご覧ください）。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただくとともに、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。

小郡三井医師会より

感染症対策担当理事 橋本朋也
会長 島田昇二郎

(健Ⅱ566F)
令和4年2月21日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

釜 菡 敏

武田モデルナ社ワクチンの外箱及び元箱の寸法変更について

今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛て標記の事務連絡がなされましたので、ご参考までにご連絡いたします。

今般、武田/モデルナ社ワクチンの販売名が「スパイクバックス TM 筋注(旧販売名: COVID-19 ワクチンモデルナ筋注)」に変更されることに伴い、別添「『COVID-19 ワクチンモデルナ筋注』の販売名、外箱寸法等の変更について」のとおり、それらの箱の寸法が変更になりました。また、武田薬品工業社からの情報によれば、TM3rd03 クール及び TMdp3rd01 クール(2月21日週配送)の配送分からはほとんどのワクチンが「スパイクバックス TM 筋注」に切り替わる見込みです。

外箱及び元箱の寸法の変更に伴う冷凍庫への収納可能箱数の変更があり、特に、日本フリーザー社の冷凍庫については、元箱のまま冷凍庫内に収納することができなくなったため、ワクチン配送時に会場側担当者にて速やかに開梱し、外箱で当該冷凍庫に収納する必要があります(詳細は別添をご覧ください)。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会および関係医療機関に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。

事 務 連 絡
令和 4 年 2 月 16 日

各

都道府県
市 町 村
特 別 区

 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

武田/モデルナ社ワクチンの外箱及び元箱の寸法変更について

武田/モデルナ社ワクチンの配送にあたっては、10バイアルが収納された外箱と、外箱が12箱入った元箱を組み合わせて行われているところですが、今般、武田/モデルナ社ワクチンの販売名が「スパイクボックス™筋注(旧販売名:COVID-19 ワクチンモデルナ筋注)」に変更されるに伴い、別添「『COVID-19ワクチンモデルナ筋注』の販売名、外箱寸法等の変更について」のとおり、それらの箱の寸法が変更になるとの連絡がありましたのでお知らせします。また、武田薬品工業社からの情報によれば、TM3rd03クール及びTMdp3rd01クール（2月21日週配送）の配送分からほとんどのワクチンが「スパイクボックス™筋注」に切り替わる見込みです。

外箱及び元箱の寸法の変更に伴う冷凍庫への収納可能箱数の変更については別紙のとおりとなりますのでご注意ください。

特に、日本フリーザー社の冷凍庫については、元箱のまま冷凍庫内に収納することができなくなったため、ワクチン配送時に会場側担当者にて速やかに開梱し、外箱で当該冷凍庫に収納する必要がありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。また、PHC社、日本フリーザー社及びEBAC社の冷凍庫について、外箱の収納可能数が減少しますので、接種計画及び配送受入計画への影響を確認するようお願いいたします。冷凍庫の容量が不足する場合には、早期に使用する目処がついているワクチンを冷蔵庫に移し替えるなどの対応をお願いいたします。

なお、ワクチン配送時に速やかに外箱で収納することができるよう、武田薬品工業社から各卸業者に協力をお願いするとのことですので、あわせてお伝えします。

以上

別添

令和4年2月16日

厚生労働省 健康局 健康課 予防接種室 御中

武田薬品工業株式会社

「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の販売名、外箱寸法等の変更について


当社が販売する「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の販売名、外箱寸法等を変更いたしますので、ご案内申し上げます。詳しくは次頁をご参照ください。当該変更に関する医療機関又は接種会場への情報提供活動は2月17日より行います。

以上

「COVID-19ワクチンモデルナ筋注」の 販売名、外箱寸法等の変更のご案内

販売名の変更について

販売名を「スパイクバックス™筋注（旧販売名：COVID-19 ワクチンモデルナ筋注）」に変更することに伴い、組箱・バイアルラベルのデザインを変更いたします。

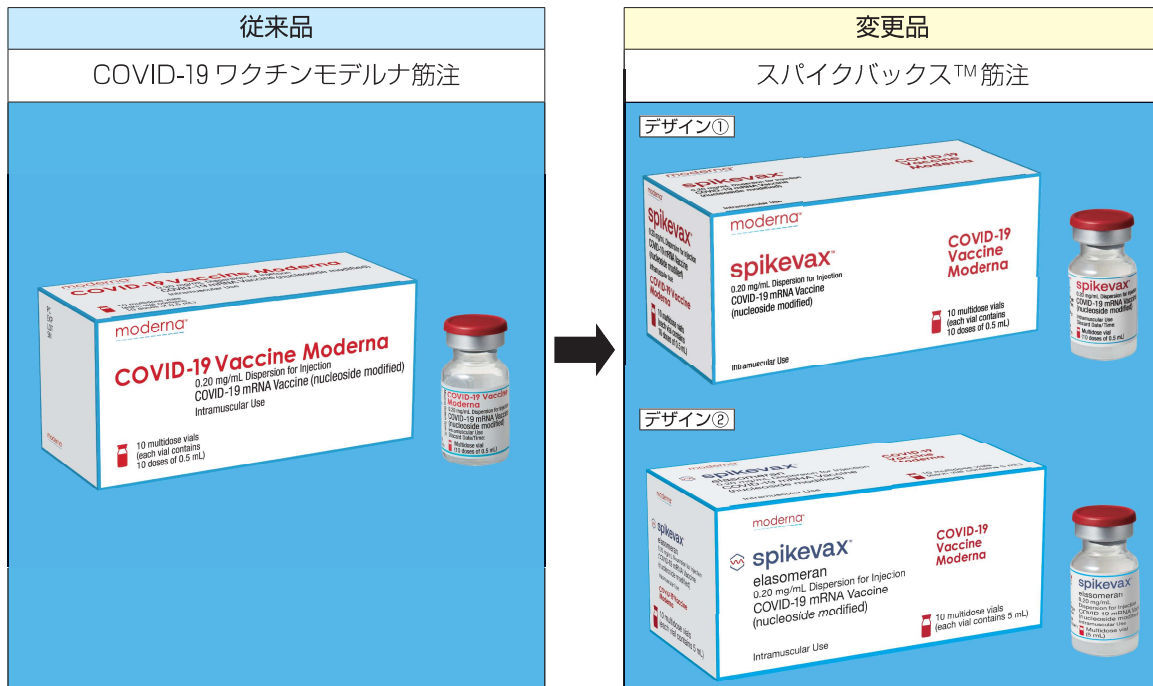

- * 販売名は変更になりますが、効能又は効果、用法及び用量等接種上の注意（含・接種不適當者）は、同じです。
- * スパイクバックス筋注は、外箱及びバイアルラベルのデザインを全世界で共通化するためデザイン①よりデザイン②に変更します。
- * 当社及び地域担当卸の在庫状況により両販売名の製品（スパイクバックス筋注については、2種類のデザイン製品）が同時期に流通する可能性があります。

外箱等寸法

	従来品：COVID-19 ワクチンモデルナ筋注	変更品：スパイクバックス™筋注	
		デザイン①	デザイン②
外箱（10バイアル封緘）	126 × 51 × 60mm	130 × 61 × 61mm	130 × 61 × 61mm
元箱（外箱 12 箱封緘）	267 × 169 × 135mm	280 × 200 × 140mm	280 × 200 × 140mm

変更品コード一覧

「YJ コード」を除き、各種コードは COVID-19 ワクチンモデルナ筋注と同じです。

製品名	GS1コード		
	調剤包装単位	販売包装単位	元梱包装単位
スパイクバックス™筋注	04987123565202	14987123002407	24987123002404

製品名	統一商品コード	HOT13番号	JANコード	YJコード
スパイクバックス™筋注	123002400	1821116010101	4987123002400	631341EA1038

* 上記の各種コードは、スパイクバックス筋注のデザイン①とデザイン②で共通です。

変更品出荷時期・Lot 番号

製品名	包装	変更品出荷時期	変更品初回 Lot 番号
スパイクバックス™筋注	5mL×10バイアル	デザイン① 2022年1月	000048A
		デザイン② 2022年2月末予定	未定

* 変更品の納入時期は当社及び地域担当卸の在庫状況により変更品出荷時期と異なる場合がありますこと、ご了承ください。

-20℃冷凍庫における武田／モデルナ社ワクチン収納可能箱数の変更


- 武田／モデルナ社ワクチンの販売名変更（COVID-19 ワクチンモデルナ筋注⇒スパイクバックス™筋注）に伴い、下記のとおり箱サイズが変更され、冷凍庫への収納可能箱数にも変更が生じました。
- 今回の変更により、日本フリーザー社の冷凍庫については元箱のまま冷凍庫内に収納することができなくなったため、ワクチン配送時に会場側担当者にて速やかに開梱し、外箱で収納していただく必要があります。冷凍庫の頻繁な開閉、長時間の開放による庫内温度の上昇や結露には十分ご注意ください。

外箱（10バイアル） （150回接種分）



収納可能箱数

元箱（外箱×12＝120バイアル） （1,800回接種分）

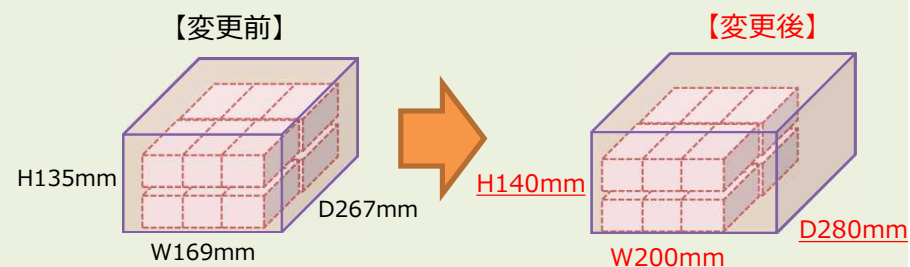

収納可能箱数


PHC	日本フリーザー	EBAC	PHC	日本フリーザー	EBAC
					
フリーザー部			フリーザー部		
72箱 = 720バイアル ↓ <u>60箱 = 600バイアル</u>	96箱 = 960バイアル ↓ <u>82箱 = 820バイアル</u>	90箱 = 900バイアル ↓ <u>80箱 = 800バイアル</u>	2箱 (= 外箱24) ↓ <u>変更なし</u>	7箱 (= 外箱84) ↓ <u>収納できない</u> ※開梱して外箱82は収納可	4箱 (= 外箱48) ↓ <u>変更なし</u>

参考：日本フリーザー社製冷凍庫への収納方法について


- ・上段引出しサイズ(3個): W350 × D360(有効 D310) × H135mm
- ・下段引出しサイズ(1個): W350 × D220(有効 D140) × H135mm




※引出しの底面後方に傾斜有り(下段引出しは前方も)。

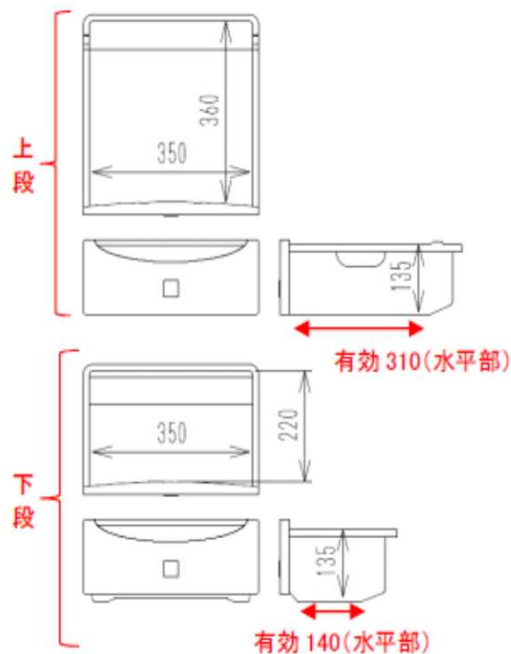


下図のように収納することで、
外箱82箱を収納することが可能です。
(上段 = **24箱 × 3**、下段 = **10**)

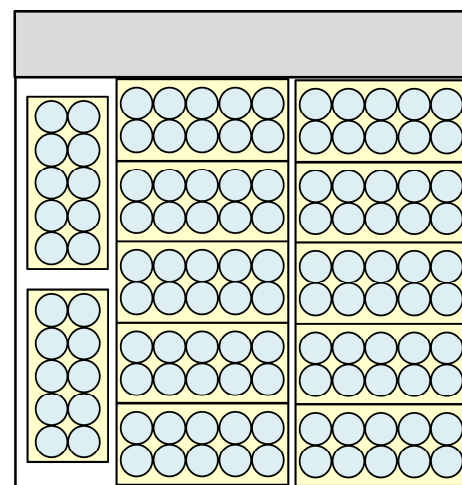


平面図(上段引出し)

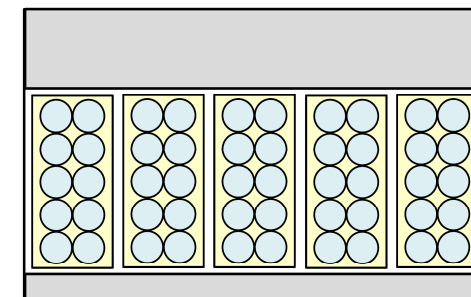

平面図(下段引出し)

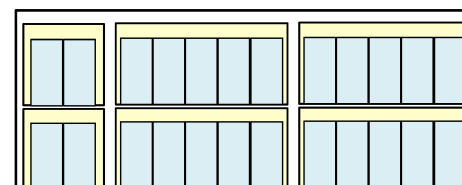

正面図(上段引出し)

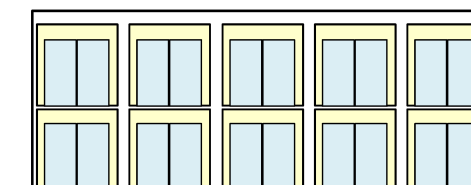

正面図(下段引出し)

□ : 引出し内の傾斜部分